




ENTRENAMIENTO DEL SISTEMA TANDEM MOBI

Lista de verificación de los suministros




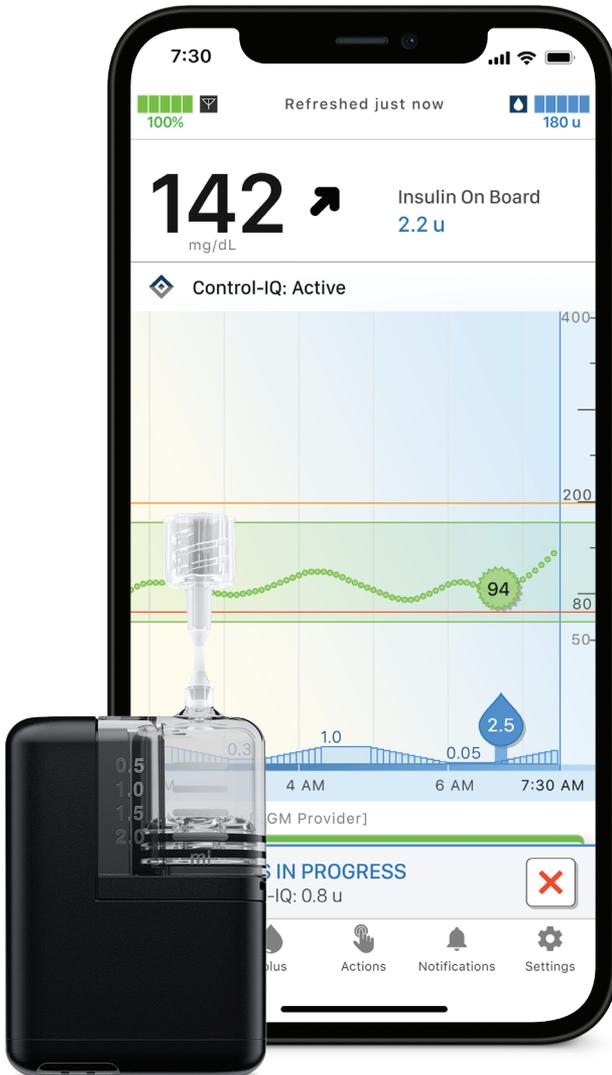

INSTRUCCIONES

Confirme que tiene todos los suministros de esta lista antes de su entrenamiento programado.

Suministros del sistema Tandem Mobi



Teléfono inteligente compatible con la aplicación móvil Tandem Mobi* instalada

Nota: Traiga el cargador de su teléfono.



Caja del sistema Tandem Mobi



Caja de los accesorios y las instrucciones del sistema Tandem Mobi



2-3 cartuchos



Equipos de infusión

Nota: Traiga 2-3 unidades de cada tipo de equipo de infusión que recibió.



Fundas adhesivas[†]

Continuar en el siguiente panel →

Suministros adicionales



Frasco completo de insulina Humalog o NovoLog U-100



Hisopos con alcohol o toallitas para la preparación de la piel

Suministros para el monitoreo de la glucosa[‡] (es posible que no todos sean aplicables)



MCG Dexcom G6

■ **Nota:** Es posible emparejar un sensor activo con la bomba de insulina durante el entrenamiento.



MCG Dexcom G7

■ **Nota:** Es posible emparejar un sensor activo con la bomba de insulina durante el entrenamiento. Consulte a continuación para información importante sobre la compatibilidad del MCG.



Medidor de glucosa en sangre con tiras de prueba

Compatibilidad del MCG



El sensor Dexcom G7 es compatible si la fecha de fabricación es de 2024 o posterior o si el lado de la caja tiene una línea blanca debajo del número LBL.



Dexcom G7

Si tiene preguntas sobre los sensores G7 compatibles, visite tandemdiabetes.com/G7support.

Para solicitar un reemplazo de sensores G7 incompatibles, visite dexcom.custhelp.com/app/tandem_order.

* La aplicación móvil requiere un modelo de iPhone y sistema operativo compatibles (se adquieren por separado). Solo disponible para usuarios de la bomba que residen en Estados Unidos. Visite tandemdiabetes.com/compatibility para ver una lista completa de modelos de teléfono inteligente y sistemas operativos compatibles. † Las fundas adhesivas se adquieren por separado. ‡ Los suministros para el monitoreo de la glucosa se adquieren por separado.

Información importante de seguridad: VENTA BAJO RECETA. **Indicaciones de uso:** sistema de Tandem Mobi; la bomba de insulina Tandem Mobi con tecnología interoperable (la bomba) está destinada a la administración subcutánea de insulina a tasas fijas y variables para el manejo de la diabetes *mellitus* en personas dependientes de insulina. La bomba puede comunicarse de forma fiable y segura con dispositivos compatibles conectados por vía digital —lo que incluye un software de administración automatizada de insulina— para recibir, ejecutar y confirmar los comandos de estos dispositivos. La bomba está diseñada para usarse en el hogar en un solo paciente, y requiere una receta médica. La bomba está indicada para personas mayores de 6 años de edad.

© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Todos los derechos reservados. Tandem Diabetes Care, los logotipos de Tandem y Tandem Mobi son marcas registradas de Tandem Diabetes Care, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. Dexcom, Dexcom G6, Dexcom G7 y todos los logotipos y marcas de diseño relacionados son marcas registradas de Dexcom, Inc. en Estados Unidos y/u otros países. iPhone es una marca comercial de Apple, Inc. y está registrada en EE. UU. y otros países. Todas las marcas de terceros son propiedad de sus respectivos titulares. ML-1013278_B



TANDEM
Diabetes Care

(877) 801-6901
tandemdiabetes.com

PARA USO EXCLUSIVO
EN ESTADOS UNIDOS

